




STOP 糖尿病

糖尿病ケア通信第7号 2024. 11. 11 発行

当院では FreeStyle リブレが、9月よりリブレ2に切り替わりました。

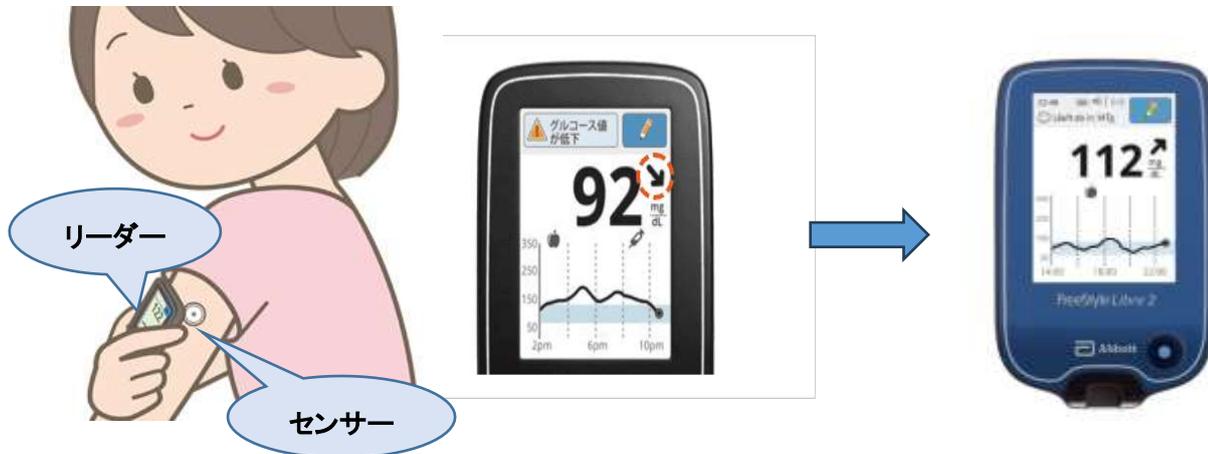

今までの機種との違いは、アラート機能がついたため、血糖値が高い時や低い時に音が鳴るように設定できます。

【リブレ Link】



スマートフォンにアプリを入れると、1分ごとに自動で血糖値が表示されます。今までは、スマートフォンをセンサーにかざす必要がありましたが、リブレ2は**6m以内に携帯をおくこと**でかざす必要がなくなります。

Q&A

- 入浴・運動できると聞いたが、注意点は？
A) センサーを装着したまま入浴、シャワー、水泳も可能。水深1mで30分間は問題なし。
リーダーは水濡れ厳禁。
- センサーを着けたままサウナに入れるか？
A) 熱くなりすぎたり冷たくなりすぎるとリーダーに🔥マーク❄️マーク（温度計マーク）が表示され、一時的にデータの測定を停止する可能性があります。（45度以上になると一時的に測定がストップされる）適切な場所に移動し再度測定して下さい。
- 指先から測定する値とグルコース値に差異があるか？
A) 生理的なタイムラグがあるため、食後、インスリン投与後、運動後など血糖値が急速に変化する時に特に差異がでる。

禁忌・禁止

1. MRI 検査前に必ずとりはずす。吸着、故障、破損、やけどが起こるおそれがある。
 2. ペースメーカー等他の埋め込み式医療機器と一緒に使用しない。誤作動の恐れがある。
- * 禁忌ではないが、正しいデータが保証されないとして、CT X-P 時もはずす必要があります。

フリースタイル取り扱い説明書より抜粋

文責：成田

